

LUMEX[®]
by graham-field



**LX9000 Gaitster Forearm Rollator
User Manual**

Para instrucciones en Español, vease la pagina 13

LX_LX9000-INS-LAB-RevC21

**Read this manual before assembling
or using the Rollator.
Save this manual for future reference.**

CONTENTS

INTRODUCTION.....	2
PRODUCT DESCRIPTION.....	2
INTENDED USE	3
SAFETY GUIDELINES—PLEASE READ BEFORE USE.....	3
WARNING / CAUTION SUMMARY	3
RAMPS AND INCLINES.....	4
CURBS AND STEPS.....	4
UNPACKING.....	5
ASSEMBLY	6
LEG FRAME ASSEMBLY	6
FRONT BRAKE CABLE CLIP INSTALLATION	6
HANDLE ASSEMBLY.....	6
CANE / CRUTCH HOLDER INSTALLATION.....	6
STORAGE POUCH INSTALLATION	7
ADJUSTMENT	7
HANDLE HEIGHT ADJUSTMENT	7
HANDGRIP / HAND BRAKE POSITION ADJUSTMENT	7
OPERATION	8
FOREARM ROLLATOR SETUP	8
WALKING WITH YOUR FOREARM ROLLATOR.....	8
STOPPING WITH YOUR FOREARM ROLLATOR	8
TO SIT IN FOREARM ROLLATOR.....	8
CLEANING AND MAINTENANCE	9
TRANSPORT AND STORAGE.....	9
SPECIFICATIONS.....	10
LIMITED WARRANTY	11

INTRODUCTION

This manual contains assembly, operation and maintenance instructions for your rollator. Read the entire manual carefully before using your rollator, and refer to it during use if you have questions.

PRODUCT DESCRIPTION



INTENDED USE

The intended use of the LX9000 Gaitster Forearm Rollator is as a rollator, a walking aid with wheels, manipulated by both arms.

⚠ WARNING: This product has a maximum weight capacity of 300 lb, EVENLY DISTRIBUTED.

SAFETY GUIDELINES—PLEASE READ BEFORE USE

The safety statements presented in this chapter refer to the basic safety information that the rollator user shall pay attention to and abide by. There are additional safety statements in other chapters or sections, which may be the same as or similar to the following, or specific to the operations. Please note the following special statements, used throughout this manual, and their significance:

⚠ WARNING: Indicates a potential hazard situation or unsafe practice that, if not avoided, could result in death or serious personal injury.

⚠ CAUTION: Indicates a potential hazard or unsafe practice that, if not avoided, could result in minor or moderate personal injury.

▲ NOTICE: Indicates a potential hazard or unsafe practice that, if not avoided, could result in product or property damage.

Info: Provides application recommendations or other useful information to ensure that you get the most from your product.

WARNING / CAUTION SUMMARY

⚠ WARNING: Important! Read and understand these instructions before assembling or using the rollator. Ensure that the rollator is assembled as described in the following pages before use. If the rollator is not properly assembled and adjusted, personal injury and/or damage to the rollator could result.

⚠ WARNING: DO NOT use this product without proper instruction from a healthcare professional.

⚠ WARNING: GF Health Products, Inc. ("Graham-Field") assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper assembly or use of this product.

⚠ WARNING: If components are damaged or missing, contact your dealer immediately. DO NOT use substitute parts.

⚠ WARNING: Inspect the rollator weekly for proper function and wear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your authorized GF distributor for repair and/or appropriate replacement parts.

⚠ WARNING: DO NOT operate the rollator on streets or roadways.

⚠ WARNING: DO NOT operate the rollator on hilly or rough terrain, sand, wet, slippery or icy surfaces, or surfaces with impaired traction. Ensure that pathway is clear of all obstacles.

⚠ WARNING: The rollator does not offer seating or occupant restraint equivalent to the seat provided in a motor vehicle! To increase your safety while traveling in a motor vehicle, always transfer to the vehicle seat and use the restraint provided by the vehicle manufacturer.

⚠ WARNING: DO NOT tie down or attach anything to the wheels. This could cause tipping and possibly result in injury or damage to the rollator.

⚠ WARNING: Ensure that the rollator is on a stable, level surface and engage handbrakes before and during transfer or using an elevator.

- ⚠ WARNING: Unauthorized modification or the use of non-Lumex® replacement parts could change the structure of the rollator, void the warranty, and create a hazardous condition resulting in serious personal injury.**
- ⚠ WARNING: DO NOT use the rollator on stairs or escalators.**
- ⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.p65warnings.ca.gov.**
- ⚠ WARNING: GF Health Products, Inc. specifically disclaims responsibility for any personal injury or property damage which may occur during any use which does not comply with federal, state, or local laws or ordinances.**

RAMPS AND INCLINES

- ⚠ WARNING: DO NOT leave the rollator on an incline.**
- ⚠ WARNING: DO NOT turn the rollator while going downhill, as the rollator could become unstable or tip over.**
- ⚠ WARNING: DO NOT attempt any incline or decline greater than six degrees (10% grade, or one foot of rise or fall per ten feet of ramp length).**

Ramps and inclines should only be negotiated with the assistance of an attendant. To attendant: Practice with a healthcare professional first before attempting ramps or inclines. Always inspect the ramp for hazards such as holes, slippery or uneven surfaces, etc. before starting up or down. If you can not see the entire ramp, ask someone to inspect it for you.

CURBS AND STEPS

- ⚠ WARNING: Never attempt to negotiate curbs or steps with your rollator without the assistance of an attendant.**
- ⚠ WARNING: Never attempt to negotiate stairs or escalators with your rollator under any circumstances.**


Curbs, steps and stairs are dangerous obstacles that confront the rollator user. The rollator is equipped with a curb stepper that can assist you when tilting the rollator to get over taller obstacles like curbs. When you encounter steps and stairs, find a way around, or use the ramps now available in most locations. If you encounter stairs or escalators and there is no ramp available, avoid the stairs or escalators by utilizing the disabled designated elevators now required in most locations. Curbs and steps should only be negotiated with the assistance of an attendant.

UNPACKING

Unless the rollator is to be used immediately, retain box and packaging materials for storage until use is required.

1. Check for obvious damage to the carton or its contents. If damage is evident, please notify the carrier and your GF authorized distributor.
2. Remove all loose packing from the box.
3. Carefully remove all the components from the carton.

Each box should contain the following components (see picture below):

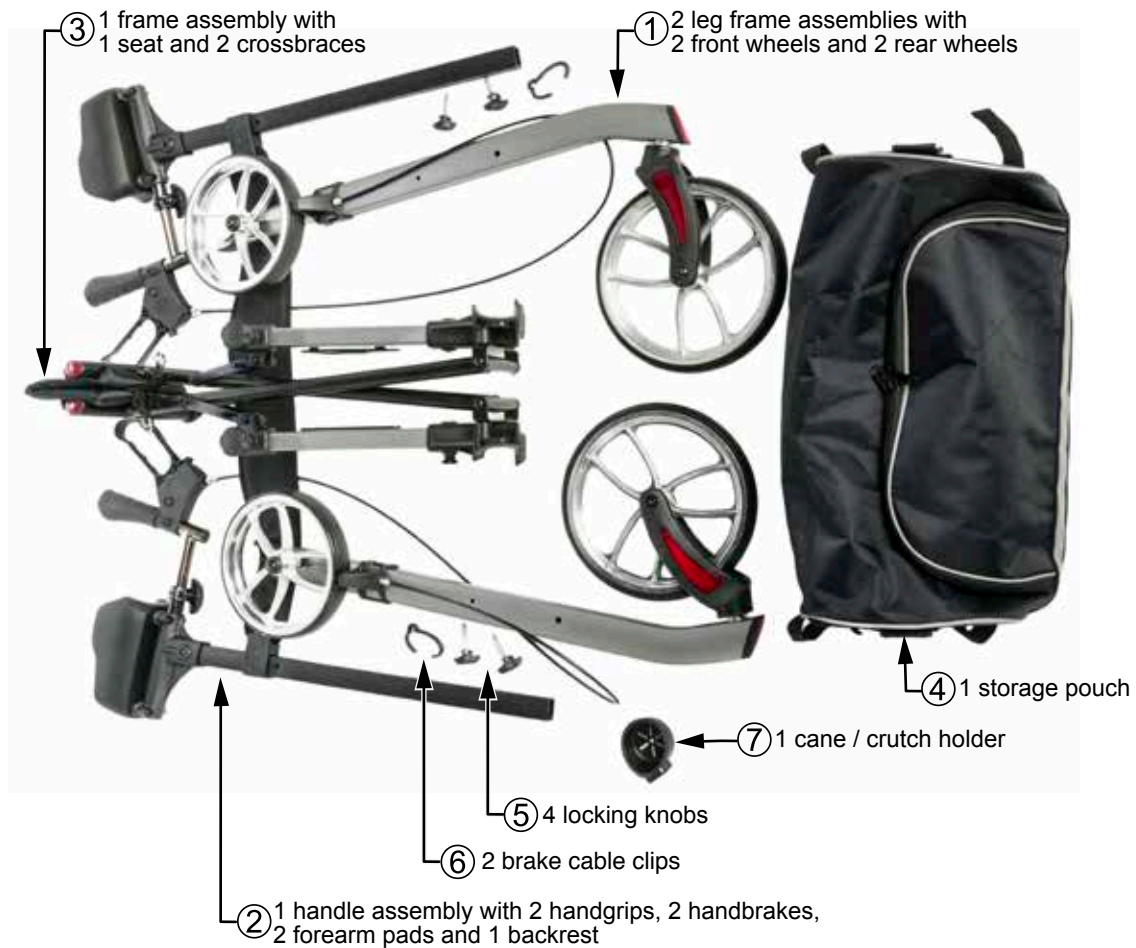

Item	Qty	Description
1	2	leg frame assemblies with 2 front wheels and 2 rear wheels
2	1	handle assembly with 2 handgrips, 2 handbrakes, 2 forearm pads and 1 backrest
3	1	frame assembly with 1 seat and 2 crossbraces
4	1	storage pouch
5	4	locking knobs
6	2	brake cable clips
7	1	cane / crutch holder

Info: Items 1 and 2 are connected by brake cables.

ASSEMBLY

LEG FRAME ASSEMBLY

1. Position the rollator frame assembly and leg frame assemblies on their sides as shown at near right.
2. Install the leg frame assemblies on inside of rollator frame assembly as shown at right.

Info: for correct assembly, ensure wheel / fork reflectors and rear wheel braking system are on outside of frame.



3. Tighten both screws on outside of leg frame assemblies as shown above.

⚠ WARNING: Ensure the leg frame assemblies are securely installed before proceeding.

FRONT BRAKE CABLE CLIP INSTALLATION

Ensure there is no interference with the brake cable, and fasten the brake cable clip on outside of leg frames, in front of frame junction, as shown above. This will help prevent the brake cable from rubbing or being caught on anything.

HANDLE ASSEMBLY

⚠ WARNING: During assembly, do not place any fingers or parts of your hand under the seat support bars.

1. Position the rollator in upright position.
2. Push down on both sides of the seat to securely lock the seat support bars into place as shown at right.
3. Install both handles in both frame tubes as shown at right.
4. Move handles to desired height — note numbers on handle shafts shown at right to match handle height.
Ensure both handles are adjusted to the same height.



5. Turn locking knobs clockwise to lock handles in place inside frame.

⚠ WARNING: Ensure locking knobs are securely tightened before proceeding.

CANE / CRUTCH HOLDER INSTALLATION

Push the cane / crutch holder into the frame connector until it snaps into place, as shown at right.

⚠ WARNING: Ensure the cane / crutch holder is securely installed before use.



STORAGE POUCH INSTALLATION

1. Install the storage pouch on the frame's wire hangers, shown at near right just below front of seat.
2. Secure hook and loop straps around both legs, as shown at middle right.
3. Secure hook and loop straps around front of frame just behind front wheel, as shown at upper far right, where hook and loop straps are shown fastened over front brake cable clip.



The storage pouch, shown correctly installed at right, can be conveniently removed to place items and then reattached, no tools needed.

⚠ WARNING: Ensure the storage pouch is securely installed before use.



ADJUSTMENT

HANDLE HEIGHT ADJUSTMENT

Info: Consult your healthcare professional, distributor or caregiver to assist you in finding the best handle height for you.

1. Turn both locking knobs, shown at right, counterclockwise to release handles inside frame.
2. Move handles to desired height — note numbers on handle shafts shown at right to match handle height.
Ensure both handles are adjusted to the same height.
3. Turn locking knobs clockwise to lock handles in place inside frame.



⚠ WARNING: Ensure locking knobs are securely tightened before use.

HANDGRIP / HAND BRAKE POSITION ADJUSTMENT

Info: The handgrips can be adjusted to an angle and depth most comfortable for the user.

Refer to picture at right.

1. Loosen both locking handles.
2. Move handgrip / handbrake assembly tubing to desired angle and depth.
Ensure both handgrips are adjusted to the same depth.
3. Tighten both locking handles to lock handgrip / handbrake assemblies in place.



⚠ WARNING: Ensure locking handles are securely tightened before use.

OPERATION

⚠ **WARNING:** Read the safety section of this manual before use.

⚠ **WARNING:** Before using the rollator, ensure the wheels are securely attached to the frame; the seat is fully in its locked position; the backrest is securely installed; the forearm pad / handgrip / handbrake is securely installed, locked, and adjusted to the appropriate user depth; and the handles are securely installed, locked, and adjusted to the appropriate user height.

Before proceeding, ensure all instructions in the previous section, **ASSEMBLY**, have been followed, and that you have read the **SAFETY** section of this manual.

FOREARM ROLLATOR SETUP

The photo at right shows the fully assembled rollator. To keep the backrest out of the way during movement, position it *away* from the handles as shown at right.

WALKING WITH YOUR FOREARM ROLLATOR

⚠ **WARNING:** Do not use resting handles (shown above) to move or push the rollator. The resting handles may be pivoted upward out of the way while walking.

1. Place your forearms on the forearm pads in a comfortable, stable position, where you can easily reach the handgrips and handbrakes.
2. Move the rollator slowly forward.
3. Select a pace that is comfortable for you.

STOPPING WITH YOUR FOREARM ROLLATOR

The rollator has loop locking handbrakes. To slow down, squeeze the handbrakes in toward the handgrips. To hold the rollator in a stationary position, push the handbrakes away from the handles, until the handbrakes lock into place; the rear wheels will then be locked into parked position. To release, pull the handbrakes toward the handgrips until the rear wheels move freely.

TO SIT IN FOREARM ROLLATOR

1. Push the handbrakes away from the handgrips until the rear wheels lock into parked position.
2. Test the wheels before sitting down to ensure the rollator will not roll.
3. Before sitting, touch the back of your legs to the edge of the seat to ensure proper positioning of the rollator.
4. Hold onto rollator handles if necessary to help you lower your body onto the seat.
5. While seated, you may rest your arms on resting handles (shown above).

⚠ **WARNING:** Distribute your body weight evenly on the rollator seat.

⚠ **WARNING:** DO NOT lean on one side of the rollator.

⚠ **WARNING:** Ensure that handbrakes stop rollator and lock in place appropriately before occupying or operating rollator. If the handbrakes are not operating correctly, see your GF authorized distributor immediately for service.



CLEANING AND MAINTENANCE

Use a clean, soft cloth and warm water to clean the rollator frame, handles, and wheels. Rinse and air dry.

▲ **NOTICE:** Do NOT use solvents and other cleaning solutions to clean any part of the rollator.

Check fit and tightness of all nuts, bolts and knobs weekly.

⚠ **WARNING:** Inspect the rollator weekly for proper function and wear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your GF authorized distributor for repair and/or appropriate replacement parts.

⚠ **WARNING:** The use of non-Lumex replacement parts will void the warranty, and could create a hazardous condition resulting in serious personal injury.

TRANSPORT AND STORAGE

The rollator is designed for easy folding and storage.

To Fold for Transport

1. Remove the storage pouch by pulling off the hook and loop straps that secure the pouch to the frame.
2. Pull the strap in the middle of the seat up to bring the crossbraces together.
3. Push the handles together; the rollator will fold easily and be ready for transport as shown at far right.



To Store

1. Remove the storage pouch by pulling off the hook and loop straps that secure the pouch to the frame.
2. Adjust the handle height to the lowest position.
3. Pull the strap in the middle of the seat up to bring the crossbraces together
4. Push the handles together; the rollator will fold easily and be ready for transport as shown at far right.

SPECIFICATIONS

DIMENSION		LX9000
Width Inside Handgrips		15.25" (387 mm)
Overall Width		27.4" (697 mm)
Overall Width Folded Upright (measured from rear wheels)		13.5" (343 mm)
Overall Depth		30.2" (768 mm)
Handle Height	Minimum	40.2" (1021 mm)
	Maximum	46.8" (1190 mm)
Forearm Pad Size		6.9" x 4.6" x 3.3" (175 mm x 118 mm x 85 mm)
Seat to Floor Height		24" (613 mm)
Approximate Height of Intended User		5'5" - 6'5" (165.1 cm - 195.6 cm)
Maximum Weight Capacity EVENLY DISTRIBUTED		300 lb (136 kg)
Product Weight		23 lb (10.43 kg)
Seat	Width	18" (460 mm)
	Depth	11" (279 mm)
Wheel Size	Front	9.25" (235 mm)
	Rear	8" (203)

LIMITED WARRANTY

SCOPE OF WARRANTY

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants to the original purchaser only that it will replace or repair components, at GF's sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. All warranties are conditioned upon the proper use of the products strictly in accordance with good commercial practice and applicable GF instructions and manuals, including proper use and maintenance. To the extent that a component is warranted by a third party, GF conveys all of its rights under that warranty to the original purchaser, to the extent permitted. This limited warranty shall only apply to defects that are reported to GF's customer service team within the applicable warranty period and which, upon examination by GF or its authorized representative, prove to be a warranty item. This limited warranty is not transferable. The warranted components and time period are set forth below:

Frame: three (3) years

Wheels, handgrips, handbrakes, forearm pads, and seat: six (6) months

The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the original customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of warranty period or the expiration date.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Distributor from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Distributor, you must contact GF directly by calling 1-770-368-4700, sending a fax request to 1-770-368-2386, or by e-mailing a request to cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided by the Customer Service Representative. Failure to abide by the specific directions will result in denial of the warranty claim.

EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following:

- 1) Defects, damage, or other conditions caused, in whole or in part, by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner;
- 2) Products which are not installed, used, or properly cleaned and maintained as required in the official manual for the applicable product;
- 3) Products considered to be of a non-durable nature including, but not limited to: tips, filters, fuses, gaskets, lubricants, and charts;
- 4) Accessories or parts not provided by GF;
- 5) Charges by anyone for adjustments, repairs, replacement parts, installation or other work performed upon or in connection with such products which are not expressly authorized in writing, in advance, by GF;
- 6) Any labor or shipping charges incurred in the replacement part installation or repair;
- 7) Costs and expenses of regular maintenance and cleaning; and
- 8) Representations and warranties made by any person or entity other than GF.

ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF ANY MODEL OR SAMPLE WAS SHOWN TO THE CUSTOMER, SUCH MODEL OR SAMPLE WAS USED MERELY TO ILLUSTRATE THE GENERAL TYPE AND QUALITY OF THE PRODUCT AND NOT TO REPRESENT THAT THE PRODUCT WOULD NECESSARILY CONFORM TO THE MODEL OR SAMPLE IN ALL RESPECTS. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PARTS. GF SHALL NOT BE LIABLE FOR AND HEREBY DISCLAIMS ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR INCOME, LOSS OF USE, DOWNTIME, COVER, OR EMPLOYEE OR INDEPENDENT CONTRACTOR WAGES, PAYMENTS AND BENEFITS.

The warranties contained herein contain all the representations and warranties with respect to the subject matter of this document, and supersede all prior negotiations, agreements and understandings with respect thereto. The recipient of this document hereby acknowledges and represents that it has not relied on any representation, assertion, guarantee, warranty, collateral contract or other assurance, except those set out in this document.

For additional information on this product or this warranty, please contact a GF Customer Service Representative.

NOTES:

- 1) Additional terms and conditions may apply.
- 2) Freight claims must be notated on the appropriate shipping documents and must be made with immediacy. International, federal and state regulations govern specific requirements for freight claims. Failure to abide by those regulations may result in a denial of the freight claim. GF will assist you in filing the freight claim.
- 3) Claims for any short shipment must be made within three (3) days of the invoice date.

graham ■■■ **field**

LUMEX[®]
by graham-field



LX9000 Gaitster Rodador Antebrazo
Manual Usuario

LX_LX9000-INS-LAB-RevC21

**Lea este manual antes de ensamblar
o utilizar el Rodador.
Guarde este manual para uso en el futuro.**

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	14
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	14
USO ENTENDIDO	15
DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR LEA ANTES DE USO	15
SUMARIO DE ADVERTENCIAS Y CAUCIONES	15
RAMPAS Y INCLINAS	16
ACERAS Y ESCALERAS	16
DESEMPACAR	17
ASAMBLEA	18
ASAMBLEA DEL MARCO DE PATA	18
INSTALACIÓN DEL CLIP DEL CABLE DEL FRENO DELANTERO	18
ASAMBLEA DE LA MANIJA	18
INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE BASTÓN / MULETA	18
INSTALACIÓN DE BOLSA DE ALMACENAJE	19
AJUSTAMIENTO	19
AJUSTE DE ALTURA DE LA MANIJA	19
AJUSTE DE LA POSICIÓN DE EMPUÑADURA / FRENO DE MANO	19
OPERACIÓN.....	20
CONFIGURACIÓN DEL RODADOR DE ANTEBRAZO	20
CAMINANDO CON SU RODADOR	20
PARANDO CON SU RODADOR DE ANTEBRAZO	20
PARA SENTARSE EN EL RODADOR.....	20
LIMPIANDO Y MANTENIMIENTO.....	21
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	21
ESPECIFICACIONES	22
GARANTÍA LIMITADA.....	23

INTRODUCCIÓN

Este manual contiene las instrucciones de ensamblaje, operación y mantenimiento para el rodador. Lea el manual entero cuidadosamente antes de usar el rodador, refiera durante uso si usted tiene preguntas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



USO ENTENDIDO

El uso entendido de la LX9000 Gaitster Rodador Antebrazo es como un rodador, un ayuda de caminar con ruedas manipulado por dos brazos.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto tiene una capacidad máxima de peso de 300 lb, DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.

DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR LEA ANTES DE USO

Las declaraciones de la seguridad presentadas en este capítulo refieren a la información de seguridad básica que el usuario del rodador prestará la atención a y que respetará cerca. Hay declaraciones adicionales de la seguridad en otros capítulos o secciones, que pueden ser el iguales que o similares al siguiente, o específico a las operaciones. Observe por favor las declaraciones especiales siguientes, usadas a través de este manual, y su significación:

- ⚠ ADVERTENCIA: Indica una situación del peligro potencial o una práctica insegura que, si no evitado, podrían dar lugar a muerte o a daños corporales serios.**
- ⚠ PRECAUCIÓN: Indica un peligro potencial o una práctica insegura que, si no evitado, podrían dar lugar a daños corporales de menor importancia.**
- ▲ AVISO: Indica un peligro potencial o una práctica insegura que, si no evitado, podrían dar lugar a daños de menor importancia al producto o daños materiales.**

Información: Proporciona las recomendaciones del uso o la otra información útil de asegurarse de que consigue la mayoría de su producto.

SUMARIO DE ADVERTENCIAS Y CAUCIONES

- ⚠ ADVERTENCIA: Importante! Lea y entienda estas instrucciones antes de ensamblar o utilizar el rodador. Asegúrese que el rodador esté ensamblado como descrito en los párrafos siguientes antes de uso. Si el rodador no está ensamblado en la manera correcta, daño personal o a la propiedad puede ocurrir.**
- ⚠ ADVERTENCIA: NO utilice este producto sin instrucciones de su profesional de la salud.**
- ⚠ ADVERTENCIA: GF Health Products, Inc. ("Graham-Field") no asume responsabilidad alguna por daños o heridas causadas por ensamblaje incorrecto de este producto.**
- ⚠ ADVERTENCIA: Si componentes están dañados o no están presentes, contacte a su distribuidor autorizado de productos GF inmediatamente. No substituya piezas.**
- ⚠ ADVERTENCIA: Revise el rodador semanalmente para función propio y uso. Si algún componente no está trabajando correctamente o se parece usado, contacte a su distribuidor autorizado de productos GF para reparación y/o partes reemplazados.**
- ⚠ ADVERTENCIA: NO opere el rodador en calles o calzadas.**
- ⚠ ADVERTENCIA: NO opere el rodador en terreno agreste o monte, tierra, superficies mojadas y heladas, o superficies con tracción dañado. Asegúrese que el camino está libre de todos obstáculos.**
- ⚠ ADVERTENCIA: El rodador no ofrece asiento o restricción de ocupante equivalente a la silla pródigo en un vehículo de motor! Para aumentar su seguridad mientras viajando en un vehículo de motor, siempre transfiere al asiento de vehículo y use una restricción pródigo por su fabricante de vehículo.**
- ⚠ ADVERTENCIA: NO amarre o sujete nada a las ruedas. Esto puede causar volcado y posiblemente resultar en herida o daño al rodador.**
- ⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese que el rodador está en un superficie estable y nivel, y engrane los frenos de mano antes de y durante transfiriendo o usando un elevador.**

- ⚠ ADVERTENCIA: Modificación no autorizado o uso de partes de reemplace que no son de Lumex® puede cambiar la estructura del rodador, puede ser que la garantía se hace inválida, y causar una condición peligroso resultando en herida seria personal.**
- ⚠ ADVERTENCIA: NO use el rodador en escaleras o escaleras mecánicas.**
- ⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo - www.p65warnings.ca.gov.**
- ⚠ ADVERTENCIA: GF Health Products, Inc. específicamente renuncia responsabilidad por cual quiere herida personal o daño a propiedad que puede ocurrir durante uso que no cumple con las leyes federales, del esta o leyes y ordenanzas locales.**

RAMPAS Y INCLINAS

- ⚠ ADVERTENCIA: NO deje el rodador en una inclina.**
- ⚠ ADVERTENCIA: NO de vuelta al rodador mientras yendo cuesta abajo, o si no el rodador puede volcar.**
- ⚠ ADVERTENCIA: NO intente cual quiere inclina o descenso mas de seis grados (10% pendiente, o un pie mas alto o caer por diez pies de longitud del rampa.**

Rampas y Inclinas deben ser negociados con la asistencia de un atendiente. Para el atendiente: Practica con un profesional de cuidado de salud antes de tratar rampas y inclinas. Siempre examine la rampa para peligros como huecos, superficies resbalosas o desiguales, etc. antes de subir y bajar. Si no puede ver la rampa entera, pide ayuda de alguien que lo puede examinar para usted.

ACERAS Y ESCALERAS

- ⚠ ADVERTENCIA: Nunca trate de negociar aceras y escaleras con el rodador sin asistencia de un atendiente.**
- ⚠ ADVERTENCIA: Nunca trate de negociar aceras y escaleras con el rodador debajo cual quiere circunstancia.**

Bordillos, pasos y escaleras son obstáculos peligrosos para usuarios de rodador. El andador está equipado con un paso a paso que lo puede ayudar al inclinar el andador para superar obstáculos más altos como los bordillos. Cuando se encuentra con pasos y elcaleras, busca otra manera o use una rampa que son disponibles en la mayoría de sitios. Si se encuentra con escaleras o escaleras mecánicas y no hay rampa disponible, evite las escaleras y escalera mecánica y utilice un elevador para los decapitados requeridos en la mayoría de sitios. Bordillos y pasos solo deben ser negociados con la asistencia de un atendiente.

DESEMPACAR

A menos que el rodador va ser usado inmediatamente, guarde la caja y materiales de almacenaje para almacenaje hasta que uso es requerido.

1. Cheque por daño obvio al cartón y los contenidos. Si hay daño evidente, notifique a su compañía de transportes y a su distribuidor autorizado de productos GF.
2. Remueve todo las materiales de almacenaje suelto de la caja.
3. Con cuidado remueve todos los componentes del cartón.

Cada caja debe contener los componentes siguientes (ver imagen abajo):



Artículo	Cantidad	Descripcion
1	2	conjuntos de pata con 2 ruedas delanteras y 2 ruedas traseras
2	1	conjunto de mango con 2 empuñaduras, 2 frenos de mano, 2 almohadillas para antebrazo, y 1 respaldo
3	1	conjunto de marco con 1 asiento y 2 travesaños
4	1	bolsa de almacenaje
5	4	perillas de bloqueo
6	2	clips de cable de freno
7	1	soporte de bastón / muleta

Info: Items 1 and 2 are connected by brake cables.

ASAMBLEA

ASAMBLEA DEL MARCO DE PATA

1. Coloque el conjunto del marco del rodador y la pata conjuntos de bastidor en sus lados como se muestra en cerca a la derecha
2. Instale los conjuntos del marco de la pierna en el interior de conjunto del marco del rodador como se muestra a la derecha.

Información: para ensamblaje correcto, asegúrese de que la rueda / reflectores y sistema de frenado de la rueda trasera están en el exterior del marco.



3. Apriete ambos tornillos en el exterior de los ensamblajes del marco de la pata como se muestra arriba.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que los ensamblajes del marco de la pata estén instalados de forma segura antes de continuar.

INSTALACIÓN DEL CLIP DEL CABLE DEL FRENO DELANTERO

Asegúrese de que no haya interferencia con el cable del freno y sujete el clip del cable del freno en el exterior de marcos de patas, delante de la unión del marco, como se muestra arriba. Esto ayudará a evitar que el cable del freno frotar o ser atrapado en cualquier cosa.

ASAMBLEA DE LA MANIJA

⚠ ADVERTENCIA: Durante la ensamblaje, no coloque ningún dedo o parte de su mano debajo de las barras de soporte del asiento.

1. Coloque el rodador en posición vertical.
2. Empuje hacia abajo en ambos lados del asiento para bloquear de forma segura las barras de soporte del asiento en su lugar como se muestra a la derecha.
3. Instale las dos manijas en los dos tubos del marco como se muestra la derecha.
4. Mueva las manijas a la altura deseada: anote los números en los ejes de la manija se muestran a la derecha para que coincidan con la altura de la manija.



Asegúrese de que ambos mangos estén ajustados al mismo altura.

5. Gire las perillas de bloqueo en sentido horario para bloquear las manijas en su lugar dentro del marco.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que las perillas de bloqueo estén bien apretadas antes de continuar.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE BASTÓN / MULETA

Empuje el soporte del bastón / muleta en el conector del marco hasta que encaje en su lugar, como se muestra a la derecha.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que el soporte del bastón / muleta esté instalado de forma segura antes de su uso.



INSTALACIÓN DE BOLSA DE ALMACENAJE

1. Instale la bolsa de almacenaje en los ganchos de alambre del marco, que se muestra casi a la derecha, justo debajo del frente del asiento.
2. Asegure las correas de gancho y bucle alrededor de ambas piernas, como se muestra en el centro a la derecha.
3. Asegure las correas de gancho y bucle alrededor de la parte delantera del cuadro, justo detrás de la rueda delantera, como se muestra en la esquina superior derecha, donde las correas de gancho y bucle se muestran abrochadas sobre el clip del cable del freno delantero.



La bolsa de almacenaje, que se muestra correctamente instalada a la derecha, se puede quitar convenientemente para colocar artículos y luego volver a colocarla, sin necesidad de herramientas.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que la bolsa de almacenaje esté instalada de forma segura antes de usarla.

AJUSTAMIENTO

AJUSTE DE ALTURA DE LA MANIJA

Información: Consulte a su profesional de la salud, distribuidor o cuidador para que lo ayude a encontrar la mejor altura de manija para usted.

1. Gire las dos perillas de bloqueo, que se muestran a la derecha, en sentido antihorario para liberar las manijas dentro del marco.
2. Mueva las manijas a la altura deseada: anote los números en los ejes de las manijas que se muestran a la derecha para que coincidan con la altura de las manijas.

Asegúrese de que las dos manijas estén ajustadas a la misma altura.

3. Gire las perillas de bloqueo en sentido horario para bloquear las manijas en su lugar dentro del marco.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que las perillas de bloqueo estén bien apretadas antes de usar.



AJUSTE DE LA POSICIÓN DE EMPUÑADURA / FRENO DE MANO

Información: Las empuñaduras se pueden ajustar al ángulo y la profundidad más cómodos para el usuario.

Consulte la imagen a la derecha.

1. Afloje las dos manijas de bloqueo.
2. Mueva el tubo de los conjuntos de empuñadura / freno de mano al ángulo y profundidad deseados.

Asegúrese de que ambas empuñaduras estén ajustados a la misma profundidad.

3. Apriete ambas manijas de bloqueo para bloquear los conjuntos de empuñadura / freno de mano en su lugar.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que las manijas de bloqueo estén bien apretadas antes de usar.



OPERACIÓN

⚠ **ADVERTENCIA:** Lea la sección de seguridad y instrucciones de operación en este manual antes de usar.

⚠ **ADVERTENCIA:** Antes de utilizar el rodador, asegúrese que las ruedas están armados seguramente al marco; el asiento está en su posición asegurado; el respaldo está bien instalado; la almohadilla / empuñadura / freno de mano del antebrazo está instalada, bloqueada y ajustada de manera segura a la profundidad de usuario adecuada; y las manijas están instaladas, bloqueadas y ajustadas de manera segura a la altura de usuario adecuada.

Antes de proceder, asegure que todas las instrucciones en la sección **ASAMBLEA** han sido seguido, y que ha leído la sección **SEGURIDAD** de este manual.

CONFIGURACIÓN DEL RODADOR DE ANTEBRAZO

La foto a la derecha enseña el Rodador. Para mantener el respaldo fuera del camino durante el movimiento, colóquelo lejos de las manijas como se muestra a la derecha.



CAMINANDO CON SU RODADOR

⚠ **ADVERTENCIA:** No use los mangos de descanso (mostradas a la derecha) para mover o empujar el andador. Los mangos de descanso se pueden girar hacia arriba para apartarlas mientras camina.

1. Coloque sus antebrazos en las almohadillas de los antebrazos en una posición cómoda y estable, donde pueda alcanzar fácilmente las empuñaduras y los frenos de mano.
2. Mueva su rodador hacia adelante despacio.
3. Seleccione un paso que es confortable para usted.

PARANDO CON SU RODADOR DE ANTEBRAZO

El rodador tiene frenos de mano de curva. Para parar, apriete los frenos de mano hacia las empuñaduras. Para mantener el rodador en una posición estacionario, empuje los frenos de mano lejos de las manijas hasta que los frenos de mano se aseguran en posición; las ruedas traseras se aseguran en posición. Para soltar, jale los frenos de mano hacia las empuñaduras hasta que las ruedas traseras se muevan libremente.

PARA SENTARSE EN EL RODADOR

1. Empuje los frenos de las manijas hasta que las ruedas traseras se aseguran en posición.
2. Prueba las ruedas antes de sentarse para asegurar que el rodador no va dar vuelta.
3. Antes de sentarse, toque el borde del asiento con la parte atrás de sus piernas para asegurar la posición apropiado para el rodador.
4. Aguante sobre las manijas del rodador si necesario para ayudarle sentarse en el asiento.
5. Mientras está sentado, puede descansar los brazos sobre las manijas de descanso (que se muestran arriba).

⚠ **ADVERTENCIA:** Distribuye su peso del cuerpo uniformemente en el asiento del rodador.

⚠ **ADVERTENCIA:** NO DEBE inclinarse sobre un lado del rodador.

⚠ **ADVERTENCIA:** Asegúrese que los frenos de mano paran al rodador y se aseguran en posición apropiadamente antes de ocupar o operar el rodador. Si los frenos de mano no operan correctamente, consulte a su distribuidor autorizado de productos GF inmediatamente para servicio.

LIMPIANDO Y MANTENIMIENTO

Use una toalla limpia y suave con agua tibia para limpiar el marco, los mangos, y las ruedas del rodador. Enjuague y deja que se seca al aire libre.

▲ **AVISO: NO DEBE usar solventes o otras soluciones de limpiar para limpiar el marco o la fábrica de este producto.**

Asegure que todos los tuercas, tornillo y tiradores están apretados semanalmente para asegurar que el rodador está seguro para usar.

⚠ **ADVERTENCIA: Revise el rodador semanalmente para función propio y uso. Si algún componente no está trabajando correctamente o se parece usado, contacte a su distribuidor autorizado de productos GF para reparación y/o partes reemplazados.**

⚠ **ADVERTENCIA: Uso de partes de reemplazo que no son de Lumex puede cambiar la estructura del rodador, puede ser que la garantía se hace inválida, y causar una condición peligroso resultando en herida seria personal.**

TRANSPORTE Y ALMACENAJE

El rodador es diseñado para doblar y almacenaje fácil.

Doblar para el transporte

1. Retire la bolsa de almacenamiento tirando las correas de gancho y bucle que aseguran el bolsa al marco.
2. Tire de la correa en el medio del asiento hasta arriba para unir los travesaños.
3. Empuje las manijas juntas; el rodador se doblará fácilmente y estará listo para el transporte como se muestra en el extremo derecho.

Almacenar

1. Retire la bolsa de almacenamiento tirando las correas de gancho y bucle que aseguran el bolsa al marco.
2. Ajuste la altura de las manijas al mínimo posición.
3. Tire de la correa en el medio del asiento hacia arriba para unir los travesaños.
4. Empuje las manijas juntas; el rodador se plegará fácilmente y estará listo para el transporte, como se muestra en más a la derecha.



ESPECIFICACIONES

DIMENSION		LX9000
Anchura Dentro de los Mangos		15.25" (387 mm)
Anchura Total		27.4" (697 mm)
Anchura Total Plegado en Posición Vertical (medido desde las ruedas traseras)		13.5" (343 mm)
Profundidad Total		30.2" (768 mm)
Altura de las Manijas	Mínima	40.2" (1021 mm)
	Maxima	46.8" (1190 mm)
Tamaño de la Almohadilla del Antebrazo		6.9" x 4.6" x 3.3" (175 mm x 118 mm x 85 mm)
Altura del Asiento hasta el Suelo		24" (613 mm)
Altura Aproximada de Usuario Deseado		5'5" - 6'5" (165.1 cm - 195.6 cm)
Capacidad máxima de Peso, DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE		300 lb (136 kg)
Peso del Producto		23 lb (10.43 kg)
Asiento	Anchura	18" (460 mm)
	Profundidad	11" (279 mm)
Dimensiones de la Rueda	Delantera	9.25" (235 mm)
	Trasera	8" (203)

GARANTÍA LIMITADA

AMBITO DE GARANTÍA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantía al comprador original o arrendatario (cual quiera es el "Cliente") solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. La garantía es para partes solamente y no incluye fuerza laboral o el costo de transporte. Todas garantías son condicionales por el uso apropiado del producto estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF, incluyendo uso apropiado y mantenimiento. Producto provisto a usuarios como réntales deben ser serviciados por el proveedor y inspeccionado antes de entrega. Cada usuario debe ser preparado en la operación y seguridad de este producto antes de uso. Esta garantía limitada no es transferible. Los componentes garantizados y los períodos se establecen abajo:

Marco: tres (3) años

Ruedas, empuñaduras, frenos de mano, almohadillas de antebrazo, y asiento: seis (6) meses

El período de garantía se comienza en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la período de garantía o la fecha de expiración.

OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTÍA

La garantía limitada solamente aplica a defectos reportados al Distribuidor de quien el Cliente compro el producto y quienes ellos en turno notifica al equipo de Servicio de Cliente de GF dentro el período de garantía aplicable en cuanto será examinado por GF o un representante autorizado para probar el producto sobre garantía. Falta de seguir las instrucciones específicas resultara en rechazo de la reclamación de garantía. Si no hay Distribuidor, debes llamar a GF directamente llamando 1-770-368-4700, mandando fax a 1-770-368-2386 o por email a cs@grahamfield.com. Direcciones específicos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre y GF no será responsable de lo siguiente:

- 1) Defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidentes, daños durante el transporte, manipulación indebida o dejar de solicitar y obtener la reparación o el reemplazo de una manera oportuna;
- 2) Productos que no se instalen, utilicen, limpien y mantengan de manera apropiada, como se requiere en el manual oficial aplicable para el producto;
- 3) Productos que se consideran que no son de naturaleza duradera, incluyendo, pero sin limitarse a: puntas, filtros, fusibles, juntas, lubricantes, y gráficos;
- 4) Accesorios o piezas no suministradas por GF;
- 5) Cargos por concepto de ajustes, reparaciones, piezas de recambio, instalación u otro trabajo realizado en o relacionados con tales productos que no estén autorizados expresamente por escrito, de antemano, por GF;
- 6) Cualquier gasto de mano de obra o de envío que se incurra en la instalación de la pieza de reemplazo o la reparación;
- 7) Costos y gastos del mantenimiento y limpieza regular; y
- 8) Representaciones y garantías hechas por cualquier persona o entidad que no sea GF.

GARANTÍA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DAÑOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTÍA ES LA UNICA GARANTÍA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS. GF NO HACE GARANTÍAS ENTENDIDOS DE CUALQUIERA MANERA INCLUYENDO GARANTÍAS ENTENDIDOS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PREPÓSITO PARTICULAR. SI UN MODELO Y MUESTRA SE LE ENSEÑO A UN CLIENTE, TAL MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO SOLAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO PARA REPRESENTAR QUE EL PRODUCTO SE CONFORME CON ESE MODELO Y MUESTRA EN TODOS RESPETOS. TODA RESPONSABILIDAD DE GF POR CUALQUIER PRODUCTO Y SERVICIO PROVEÍDO ES LIMITADA AL COSTO DEL PRODUCTO EN LA RECLAMACIÓN. EN NO EVENTO EN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O OTRO QUE GF SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTES INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A: DAÑOS PARA PERDIDA DE BENEFICIO O GANANCIA, PERDIDA DE USO, INACTIVO, O SALARIOS DE EMPLEADOS O TRABAJADORES CONTRACTORES, PAGOS O BENEFICIOS.

NOTAS:

- 1) Se pueden aplicar términos y condiciones adicionales.
- 2) Las reclamaciones de flete se deben anotar en los documentos de embarque apropiados y deben hacerse con inmediatez. Los requisitos específicos para las reclamaciones de fletes se rigen por regulaciones internacionales, federales y estatales. El incumplimiento de estas regulaciones podría resultar en la denegación de la reclamación de flete. GF le ayudará en la presentación de la reclamación de flete.
- 3) Las reclamaciones de embarques con faltantes se deben realizar en un plazo de tres (3) días de la fecha de la factura.

graham ■■■ **field**